



当前位置：仿制药一致性评价>>新闻动态>>新闻正文

关于规范使用“通过一致性评价”标识的通知

发布日期：2018-02-14

为落实总局《关于仿制药质量和疗效一致性评价有关事项的公告》（2017年第100号）的要求，规范“‘通过一致性评价’标识”的使用，现将标识规范参数予以发布，请企业参照使用，具体请见附件。

企业如有任何疑问，请联系我办工作人员。

联系人：刘冬

联系方式：liud@cde.org.cn

仿制药质量与疗效一致性评价办公室

2018年2月14日


相关附件

序号	附件名称
1	“通过一致性评价”标识相关参数.jpg

Copyright © 国家药品监督管理局药品审评中心 All Right Reserved.
备案序号：京ICP备09013725号 京公网安备 11010502052365号
地址：中国 北京市经济技术开发区广德大街22号院二区 邮编：100076
总机：8610-68585566 传真：8610-68584189



以R1 (100X) 为标尺

—— R1(内圆直径)=100X (两圆为同心圆)
—— R2(圆心到外圆箭头半径) =63.14X

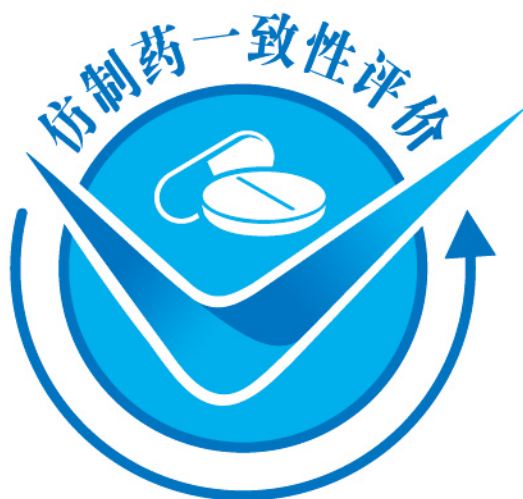

C100 M40 Y0 K0

C80 M0 Y0 K0

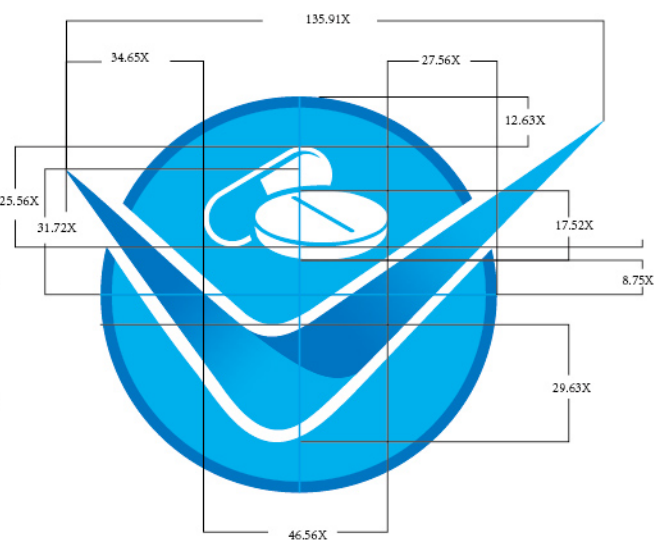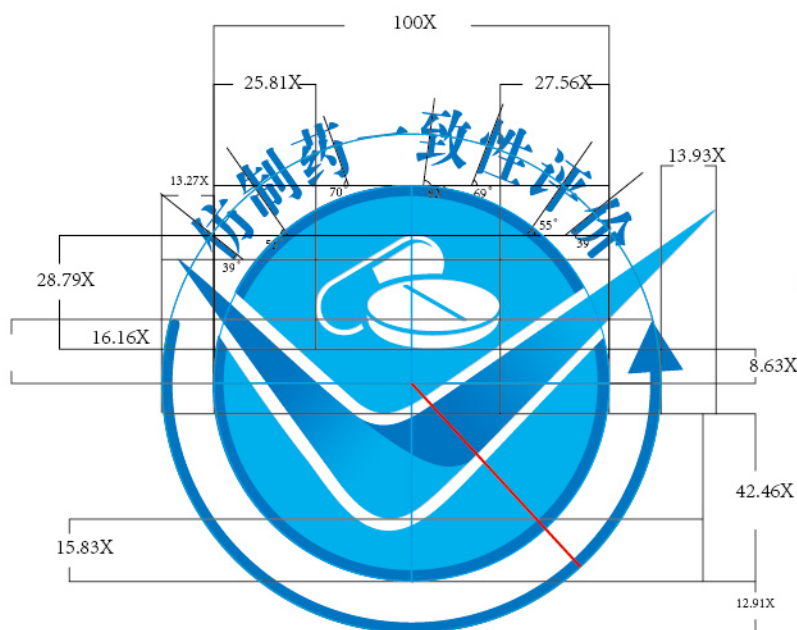

使用规范

